

# BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000040334\_00\_02  
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat: 0000040334\_00 vom 09. September 2014

---

**Messeinrichtung:** MEAC2012

**Hersteller:** SICK AG  
Nimburger Str. 11  
79276 Reute  
Deutschland

---

## Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der  
Überwachung der Emissionen und der Immissionen  
vom 14. März 2016  
Veröffentlichung: BAnz AT 14.03.2016 B7**

- V. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung von Emissionen und Immissionen:**
- 19 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes vom 12. Februar 2013 (BAnz AT 05.03.2013 B10, Kapitel III Nummer 1.1) und vom 22. Juli 2015 (BAnz AT 26.08.2015 B11, Kapitel V 1. Mitteilung)**

Die aktuelle Softwareversion des Emissionsrechners MEAC2012 der Firma SICK AG, Hamburg lautet:

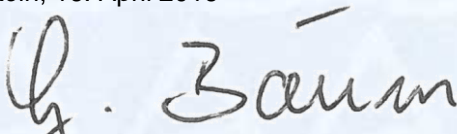
Version 3.6

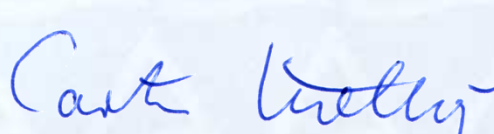
In Anlagen mit Datenfernübertragung (EFÜ) ist ein Software-Update notwendig. Die Übertragung von Meldungen und Messwertkennungen wird korrigiert. In Anlagen entsprechend der 17. bzw. 30. BImSchV wird ein Software-Update auf die neue Version empfohlen. Die Ausgabe der Meldung „ARE-Ausfall > 60 h“ wird hier korrigiert.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH vom 14. Oktober 2015

---

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Köln, 16. April 2016

  
i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum

  
i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

[www.umwelt-tuv.eu](http://www.umwelt-tuv.eu)  
tre@umwelt-tuv.eu  
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflabor.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang